BECKMAN COULTER
Life Sciences

ハイエンドハイスピードセルソーター

MoFlo Astrios *EQ/EQs*

EVERY
event matters.

MoFlo Astrios *EQ/EQs*

Enhanced Complete Sorting Package

1995年、高速セルソーターとして理想的な
フロー系のMoFloが誕生しました。

以来、MoFloは高速セルソーターの代名詞として
知られるようになりました。

MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、
MoFloの理想的なフロー系を継承し、
さらに最新の光学系とデジタルテクノロジーで進化した
高速セルソーターの完成形です。

EQ とは・・・

“*EQ*uinox”はラテン語の“aequus”（equal）と“nox”（night）から派生した言葉で、昼と夜の長さがほぼ等しくなる時を表します。

“*EQ*uinox”は、MoFlo Astrios *EQ/EQs*の200 nmから30,000 nmまでの広いダイナミックレンジをもつ洗練された散乱光検出技術“eFSC (enhanced Forward Scatter)”の機能を表します。

MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、
前方散乱光による「ナノ粒子の検出」と「検出ダイナミックレンジ」の2つの命題の両立に挑戦し、そして実現しました。

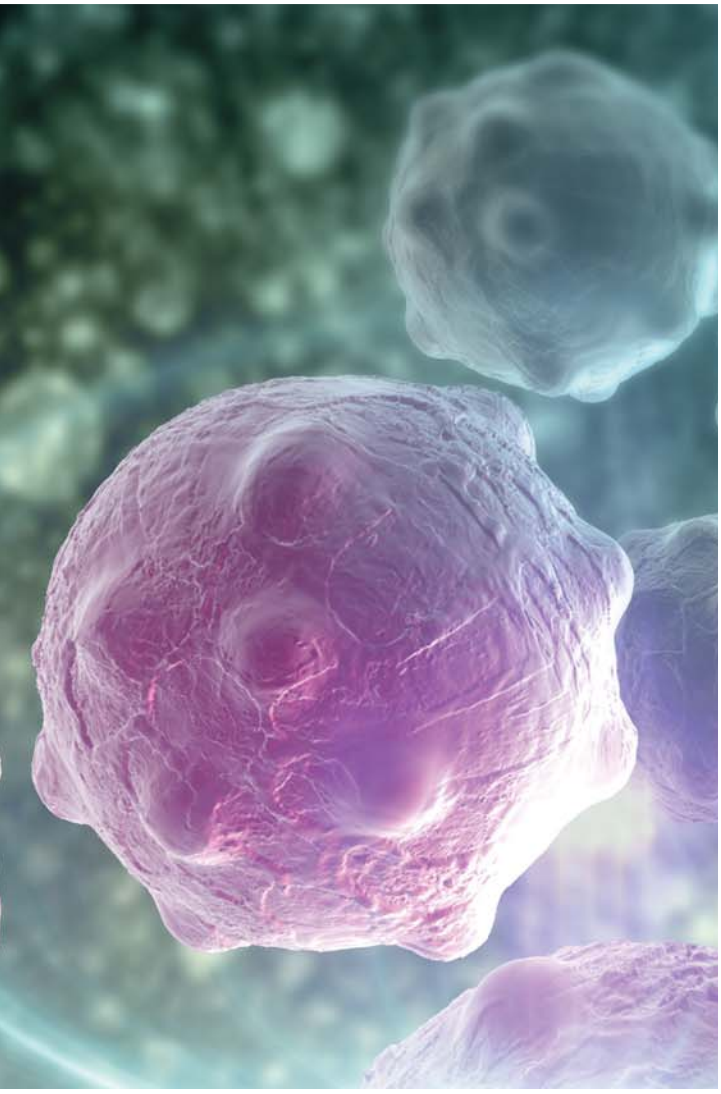

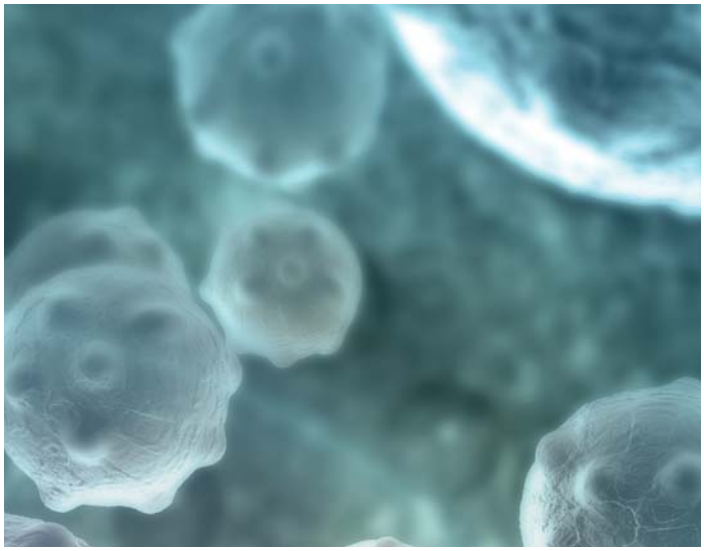

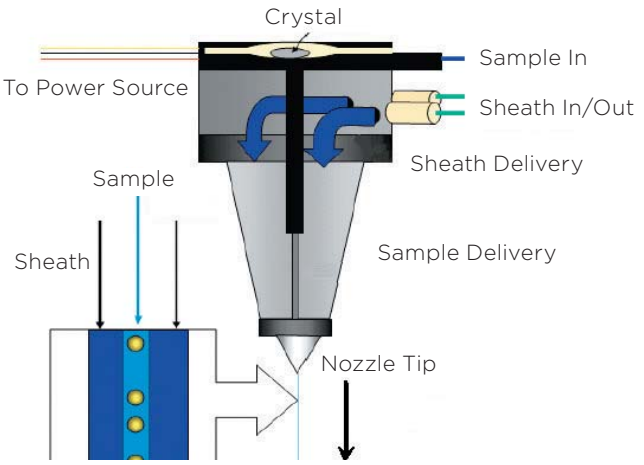
Crystal
To Power Source
Sample In
Sheath In/Out
Sheath Delivery
Sample
Sheath
Sample Delivery
Nozzle Tip

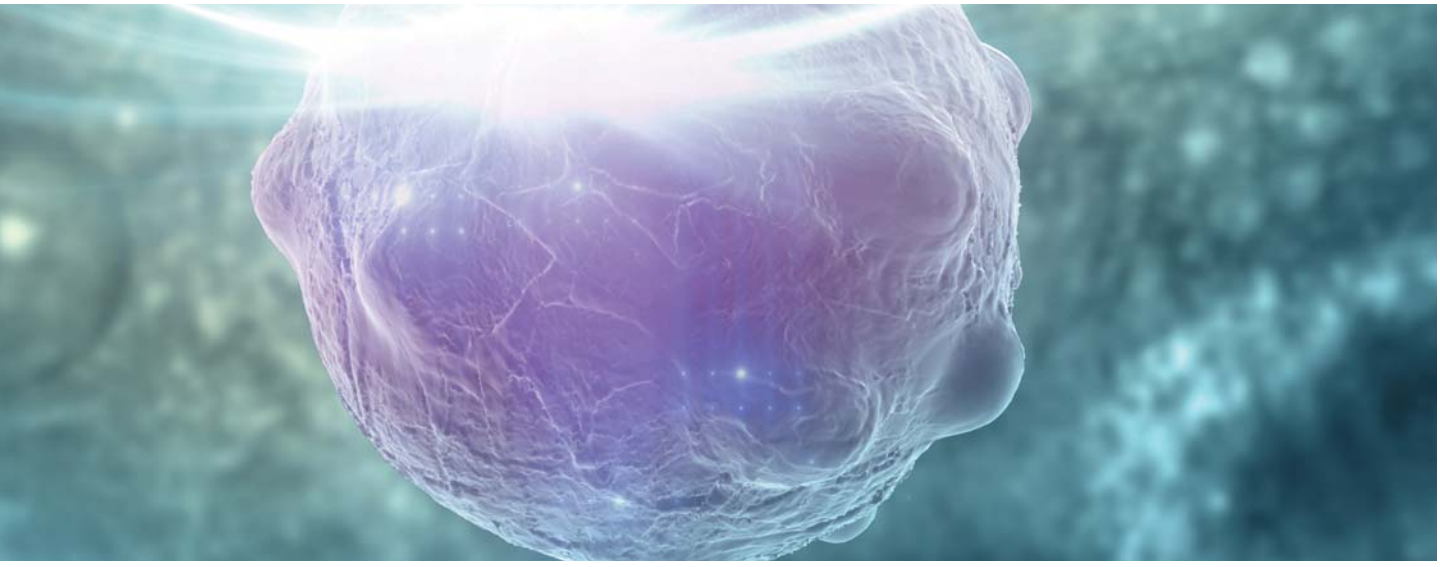

Perfect Fluidics Design

高速ソーティングを可能にする理想的なフロー系

MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、乱れのないフロー系を実現するために、フローセル内面を超平滑化したCytoNozzleを搭載しました。
CytoNozzleは理想的なフロー系を作り上げるとともに、フローセル内を通過する細胞へのダメージを最小化します。
この技術により、MoFlo Astrios *EQ/EQs*は高速ソーティングと同時に、細胞の高いViabilityとVitalityを両立し、さらに、長時間安定した高速ソーティングも実現します。

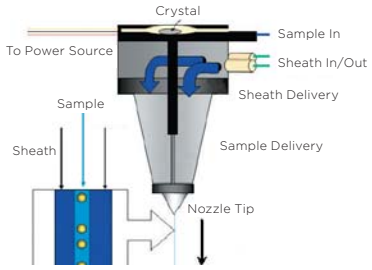

あらゆる細胞に対応可能な8種類のノズル径

様々な大きさの細胞のソーティングアプリケーションに対応できるよう、50、70、80、90、100、120、150、200 µm の8種類* のノズル径のCytoNozzleを用意しました。
微生物から大型細胞まで、アプリケーションの必要性に合わせてノズル交換を行うことができます。CytoNozzleの交換は、高感度CCDカメラによるガイドで簡単に行えます。

*IntelliSortⅡは、70、100µmノズルにのみ対応。

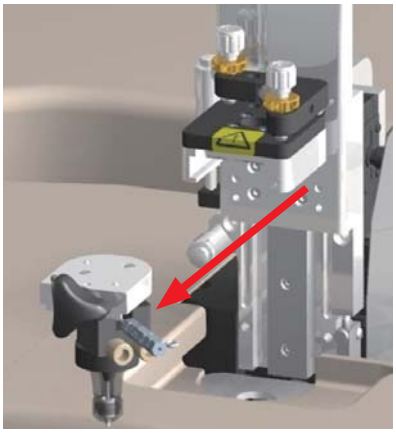

0.04 µmのシースフィルターと3ステージエアロゾルフィルターを搭載

MoFlo Astrios *EQ/EQs*の0.04 µmシースフィルターはシース液のバックグラウンドを極限まで減少させます。さらに、3連搭載の0.1 µmエアフィルターがエアロゾルを99.9999%まで減少させ、サブミクロン領域の測定とソーティングに対応します。
MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、微生物やオルガネラから大型の細胞まで、安心してソーティングすることができます。

3ステージエアロフィルター

Optics Design

7レーザー7ピンホールによる 7レーザー同時使用

MoFlo Astrios *EQ/EQs*のレーザー光学系は、マルチカラー測定に対応し、7本のレーザーの同時使用を実現しました。7本のレーザーすべてが異軸に設定され、それぞれのレーザーで励起した蛍光は、レーザーごとに対応した蛍光検出器に導かれます。これにより最大49までの蛍光または散乱光が同時検出可能です。

49PMTまで搭載可能な独立光学系

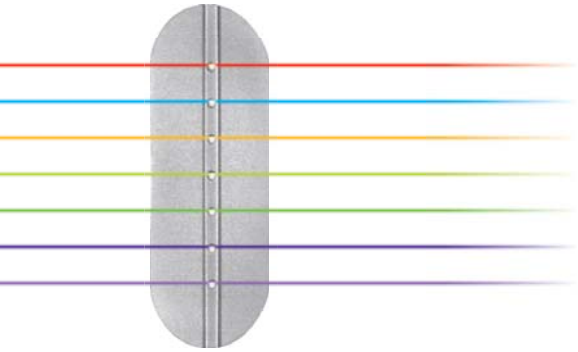

独創的な FBCOレーザー光学系

MoFlo Astrios *EQ/EQs*のレーザー光学系は、6本のレーザー軸を光ファイバーにより1つにまとめて固定化したFiber Beam Conditioning Optics (FBCO)を使用する最新の光学系を採用し、レーザー軸の調整を不要としました。
さらに、MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、レーザー集光にフラットトップビームを採用しました。
楕円集光ではサンプルの流速変化によってレーザー通過位置が変化し、細胞の散乱/蛍光のされるデータのばらつきが起きます。フラットトップビームは、このサンプルの流速変化によるデータのばらつきを最小化し、高速解析/ソーティング時でも正確なデータが得られます。
MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、使いやすさと同時にデータの正確性を提供します。

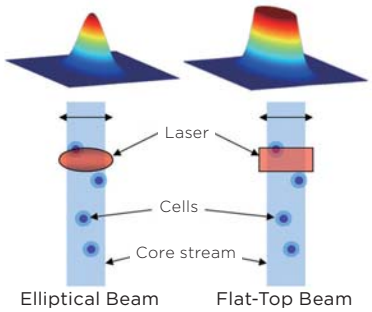

最小検出感度0.2 µmと 9ディケードのダイナミックレンジを実現する最新のeFSC検出系

MoFlo Astrios *EQ*は、前方散乱光を2つに分離して高感度に検出する新開発のeFSC検出器を搭載し、同時に2種類の前方散乱光を取得することで、0.2〜30 µmのダイナミックレンジで粒子（細胞）を検出できます*。eFSCは、小さな散乱光を高感度で検出するだけではなく、細胞の形態を最も鋭敏に捉えることができるよう設計された7つの散乱光マスクで、新たな散乱光パラメーターを取得することができます。さらに、散乱光特性はレーザー波長により変わることから、搭載しているレーザー**のいずれからも散乱光を検出できるよう設計し、より細胞の特性を示す散乱光を取得できます。
eFSCにより、今までのフローサイトメーターでは難しかったサブミクロン領域の微生物や生体内のミトコンドリアなどを検出・分取することができます。
MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、フローサイトメーターの新たなアプリケーションの可能性を広げます。

* MoFlo Astrios *EQ/EQs*の前方散乱光検出器は、1つです。
** 355 nmは除く。

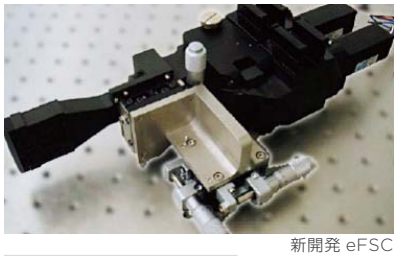

新開発 eFSC



0.2〜30µmサイズのビーズ測定例

Digital Technology

高精度デジタル波形処理回路

理想のフロー系と同時に、短時間に多くのデータ（パルス）を処理できる高速デジタル回路がなければ、真の高速セルソーターは実現できません。MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、高精度デジタル波形処理技術により23ビット100MHzのデータサンプリングを行い、高速のデータを数え落としなくデータ取得します。この高精度デジタル波形処理回路により、解析速度10万個/秒、ソーティング速度7万個/秒を実現します。
高速デジタル回路で処理されたデータは、9ディケードログで表示されます。表示ログディケードは、4から9ディケードログで自由に変更できます。

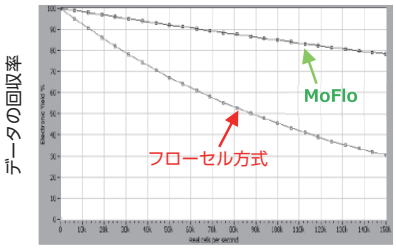

Red cells Event/Sec

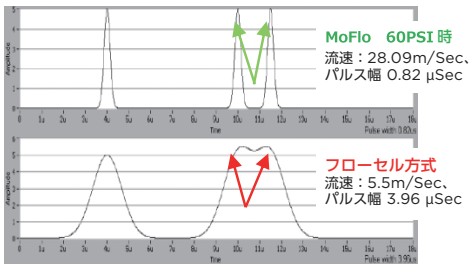

*13 µm Cell size
パルスの分離状態

高速ソーティング時でも 高純度・高回収率を実現

MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、データのノーデットタイムにより、データの数え落としによるソーティングの純度と回収率への影響をなくしました。その結果、高速ソーティング時でも99%の純度と高い回収率を実現します。

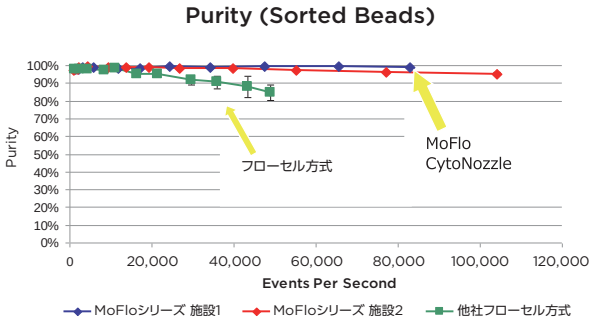

MOFLO A
TRIOS

Sorting Performance

R-Theta CyClone® アームと操作性のよいソートチャンバーデザイン

MoFlo Astrios *EQ/EQs*のR-Theta CyCloneアームは、1.4 µm±0.25 µmのステップの精度で作動し、5.1インチ/秒で移動します。この高精度な動作により、1536プレートへのソーティングを実現しました。
サンプルを捕集するソートアタッチメントは、チューブ、プレート、スライドグラス用などが標準で用意されており、クイックコネクタで簡単にR-Theta CyCloneアームに取り付けることができます。コレクションチューブ、プレート、スライドは、温度コントロールすることが可能です*。
R-Theta CyCloneアームは、ソーティングの異常を検知するソートレスキュー機能との連動により、トラブルの際には自動的にサンプルの流れを停止し、キャッチャーを安全な位置に移動させ、大事なサンプルを守ります。
ソートチャンバーは、オペレーターの安全に配慮した丸みをおびたデザインです。さらに、チャンバーはサンプル測定/ソーティングと連動し、チャンバーを開けるとサンプルの流れを自動で停止させエアロゾルの暴露を最小化する設計となっています。
ソートチャンバー内には、3か所のエアロゾルトラップを標準装備しました。AES (Aerosol Evacuation System**) に接続することで、操作中に発生するエアロゾルからオペレーターを守ります。ソートチャンバーのドアは取り外して、チャンバー内のクリーニング/メンテナンスを容易に行えます。
MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、安全でクリーンなソーティングを行うことができます。

* 温度コントローラー（恒温槽）はオプション　** オプション

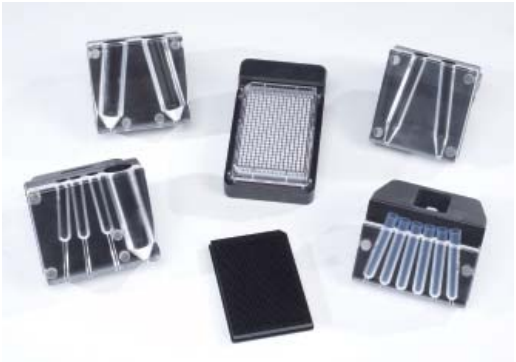

各種キャッチャーに対応

あらゆるソーティングに対応できるチューブホルダーとソートアタッチメント

様々なサンプルのソーティングに対応できるよう0.5 mL、1.0 mL、1.5 mL、5 mL、7 mL、15 mL、50 mLチューブに対応したホルダーが標準装備です。サンプリング部は温度コントロールすることが可能です*。
サンプリング部にはサンプルラインの気泡を検知するバブルディテクターが装備されています。気泡検出の際には自動的にサンプリングを停止させ、R-Theta CyCloneとの連動によりソーティングを中止します。大事なサンプルとソーティングサンプルを保護するソートレスキュー機能は、MoFlo Astrios *EQ/EQs*が到達した安全性能の一つです。

* 温度コントローラー（恒温槽）はオプション

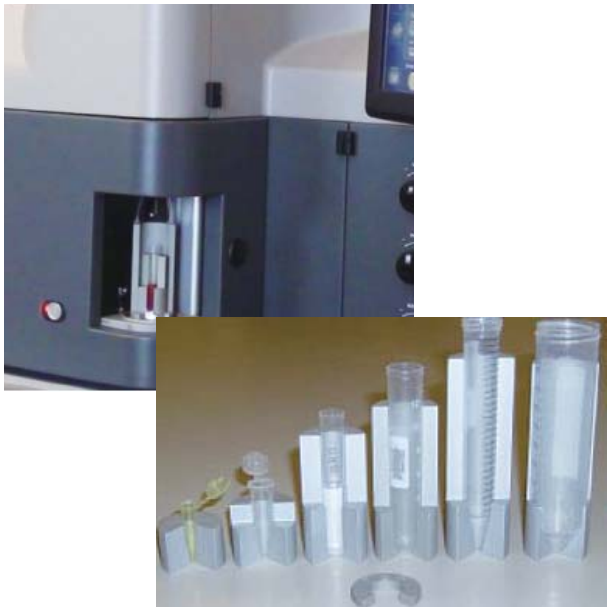

各種チューブホルダー

New Parameter

MoFlo Astrios *EQ/EQs* 独自の新散乱光パラメーター

MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、前方散乱光の取得角度を検討し、散乱光に新たな情報を追加します。従来のフローサイトメーターの散乱光取得角度は、約5～10 µmのリンパ球や細胞に適した角度の散乱光を取得してきました。
eFSCの開発にあたり、細胞の形態によって最適な散乱角度を計算し、約3万の前方散乱光マスクをテストした中から、フローサイトメーターで用いられるサンプルに有用な7つの前方散乱光マスクを採用しました。これにより、前方散乱光から従来では得られなかった情報が得られるようになりました。

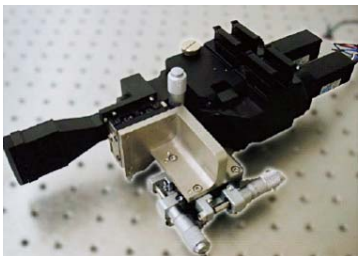

新開発 eFSCと変更可能な散乱光マスク



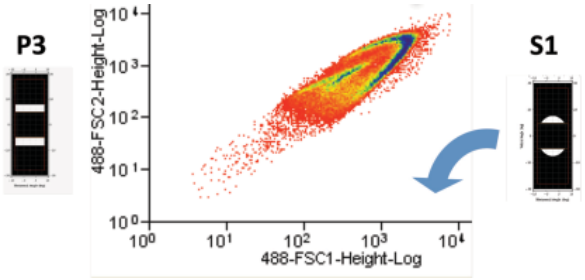

乳酸菌測定データ例*

2つの異なる角度の前方散乱を取得することで、乳酸菌を新たな角度で分離できます。

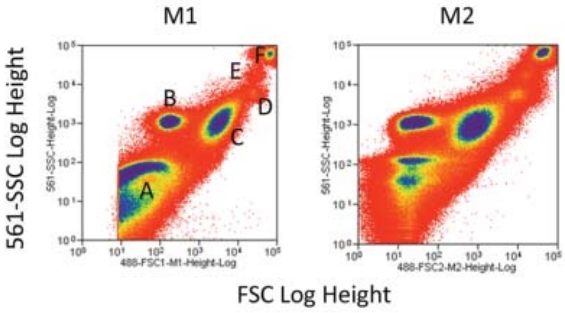

A - Microparticles　B - Platelets　C - RBC　D - Lymphocytes
E - Monocytes　F - Granulocytes

全血測定データ例*

MoFlo Astrios *EQ/EQs*の散乱光は200 nm～30 µmまでを同時に検出できるダイナミックレンジと血球サイズの分離に最適なマスク形状(M1)にできるので、全血の血小板から白血球までを同時に測定できます。

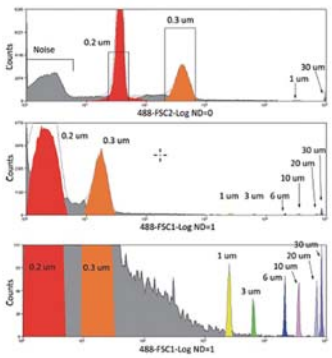

0.2～30 µmサイズのビーズ測定例

*MoFlo Astrios *EQ/EQs* 使用

Multi Color

蛍光色素選択のフレキシビリティ

MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、他に類を見ない最大49検出器とレーザーを7本まで同時使用できるデザインにより、フローサイトメーターで使用される様々な蛍光色素にフレキシブルに対応します。FITCやPhycoerythrinなどのトラディショナルな蛍光色素から、多くの蛍光タンパク質にも対応し、さらに、それらの相関を同時に測定することができます。

蛍光色素の選択の自由度が広がり、免疫学的アプローチだけではなく分子生物学的なアプローチにも対応できるフレキシビリティを持ちます。

Sorting Performance

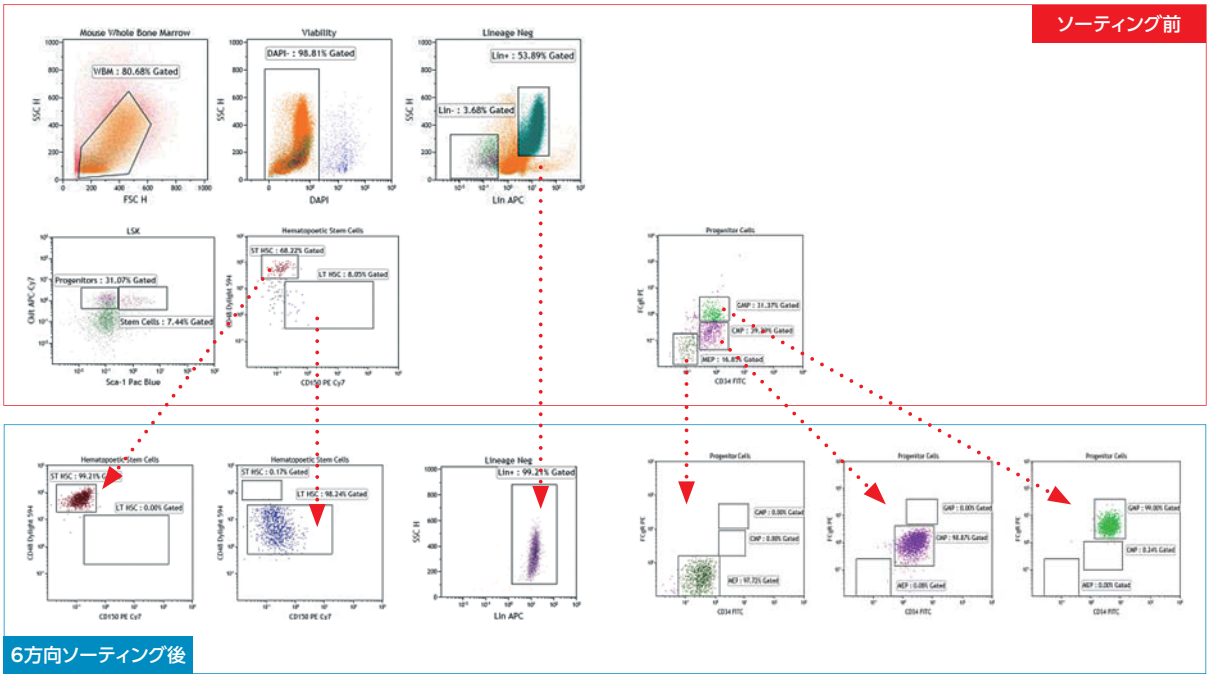

レーザー	色素		光学フィルター
UV (355 nm 100 mW)	DAPI	死細胞除去	488/59
640 nm	APC	Lineage (B220、CD3、Gr1、mac1、Ter119)	671/30
	APC-Cy7	CD117/c-kit	795/70
592 nm	DyLight594	CD48	620/29
561 nm	PE-Cy7	CD150	795/70
532 nm	PE	FCgR	576/21
488 nm	FITC	CD31	513/26
405 nm	Pacific Blue	Sca-1	448/59

マウス骨髄中の造血幹細胞の7レーザー8カラーソーティング例

データ：Vasilis Toxavidis, John Tigges & Meritxell Alberich Jorda . Hematopoietic Bone Marrow Cell Sorting Without Compromise: 7 Lasers, Eight Colors, Six Way Sorting A Novel Approach. a Beckman Coulter Life Sciences: White Paper

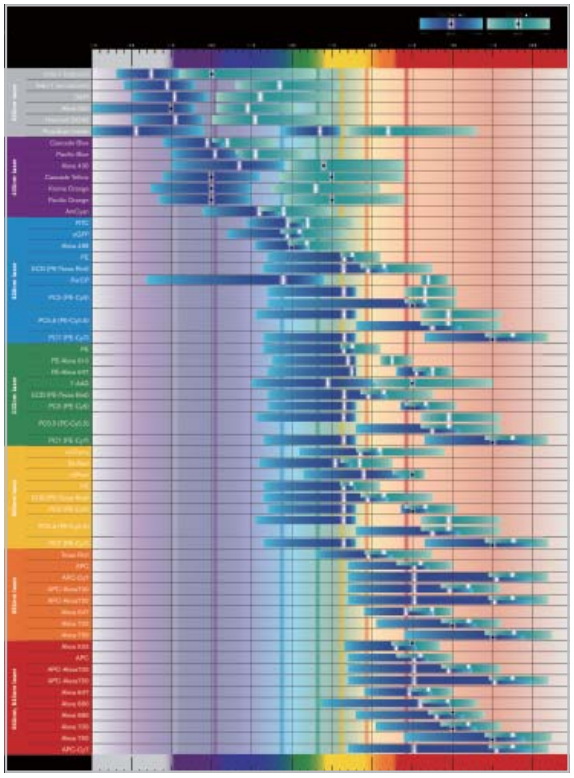

蛍光色素表

蛍光色素ポスターはサイトメトリードットコムからご依頼ください。

サイトメトリードットコム

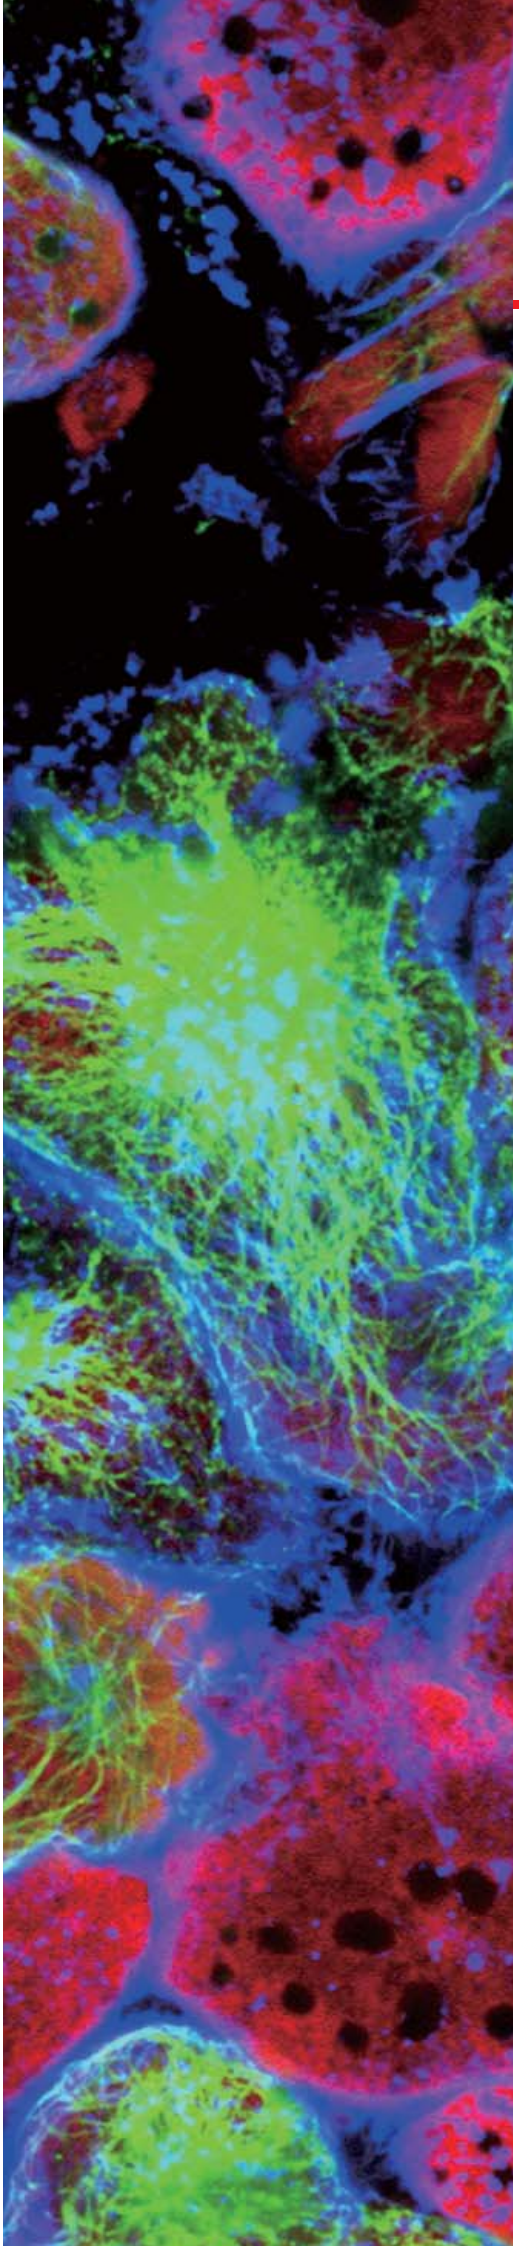

Sorting Capability

ソートフレキシビリティ

MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、あらゆる細胞を様々なアプリケーションに対応して高速でソーティングすることができます。一回のソーティングで6つまでの細胞集団をソーティングすることができるので、複数の細胞集団をソーティングしたい場合でも、短時間に従来よりも少ないサンプル量で、目的の細胞をソーティングすることができます。ソーティングするキャッチャーごとに異なる回収条件（Purify、Enrich、Single）を設定することができ、さらに、Abort Streamをソーティングすることも可能です。この機能により、希少な細胞集団を高純度（>99%）でソーティングするとともに、アボートされる細胞もソーティングし、目的の細胞すべてを回収することができます。

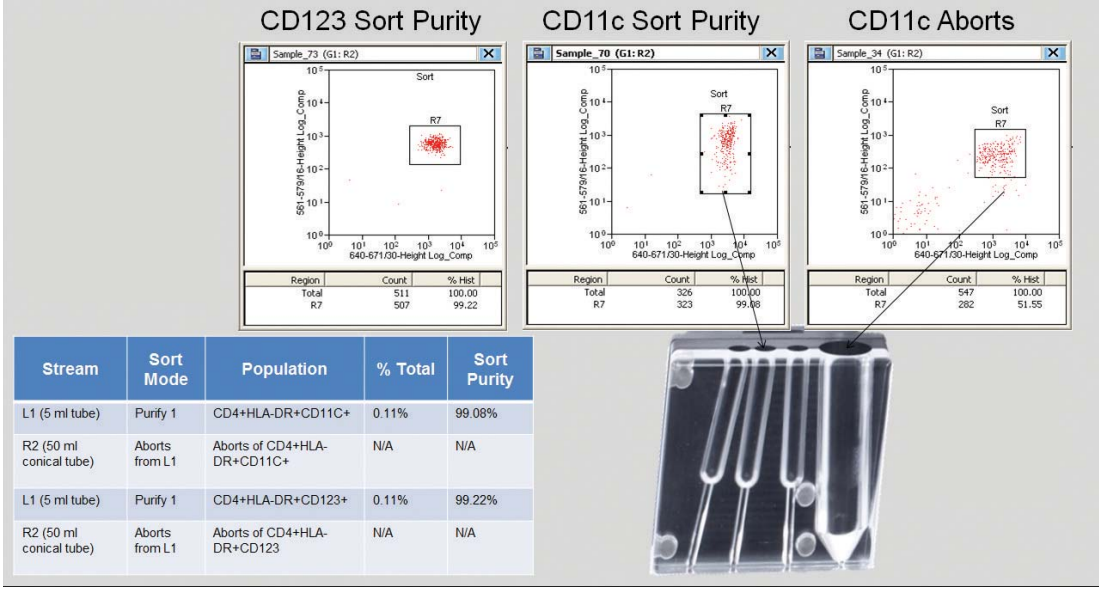

Stream	Sort Mode	Population	% Total	Sort Purity
L1 (5 ml tube)	Purify 1	CD4+HLA-DR+CD11C+	0.11%	99.08%
R2 (50 ml conical tube)	Aborts from L1	Aborts of CD4+HLA-DR+CD11C+	N/A	N/A
L1 (5 ml tube)	Purify 1	CD4+HLA-DR+CD123+	0.11%	99.22%
R2 (50 ml conical tube)	Aborts from L1	Aborts of CD4+HLA-DR+CD123	N/A	N/A

樹状細胞ソーティング例

MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、複数のキャッチャーサイズを同時に使用でき、さらに各キャッチャーチューブに異なる設定ができます。樹状細胞をソーティングした例では、純度優先モードで細胞をソーティングしたチューブは、99%以上の純度を示しています。また同時にアボートされる細胞を回収し、測定したすべての樹状細胞を回収しています。

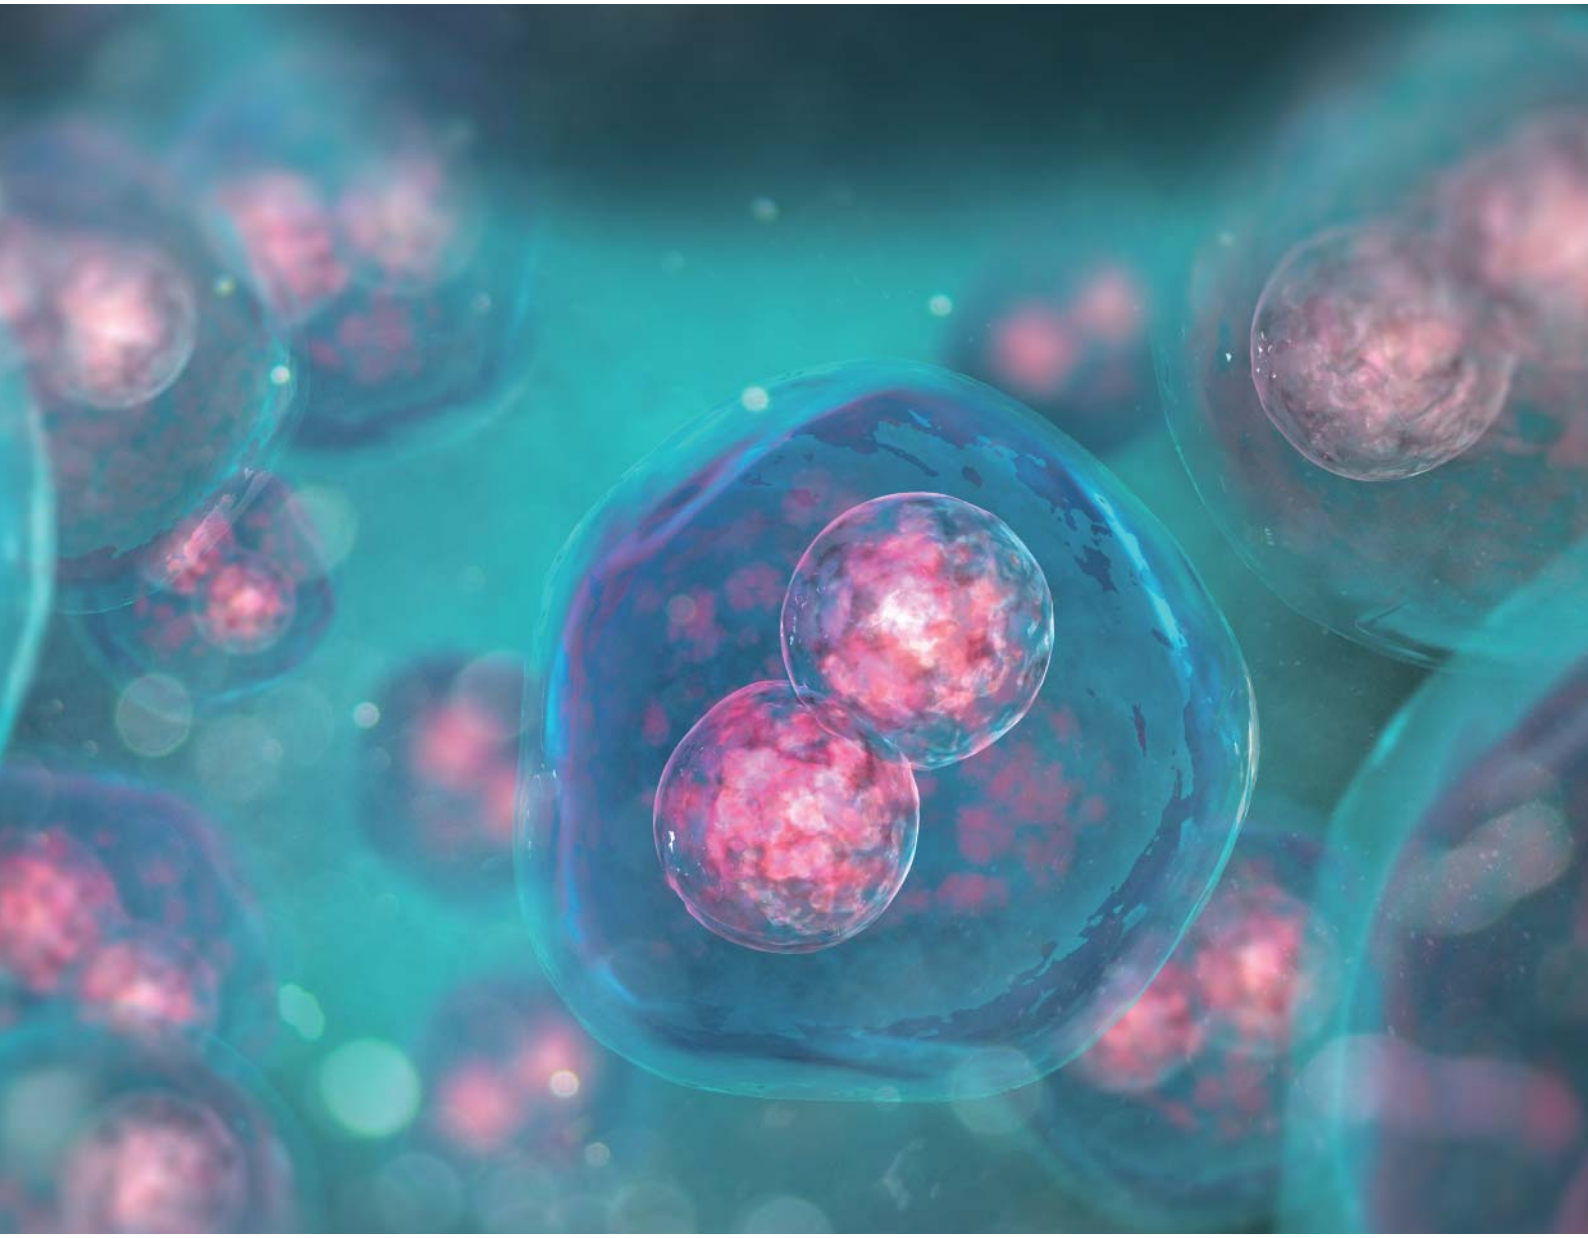

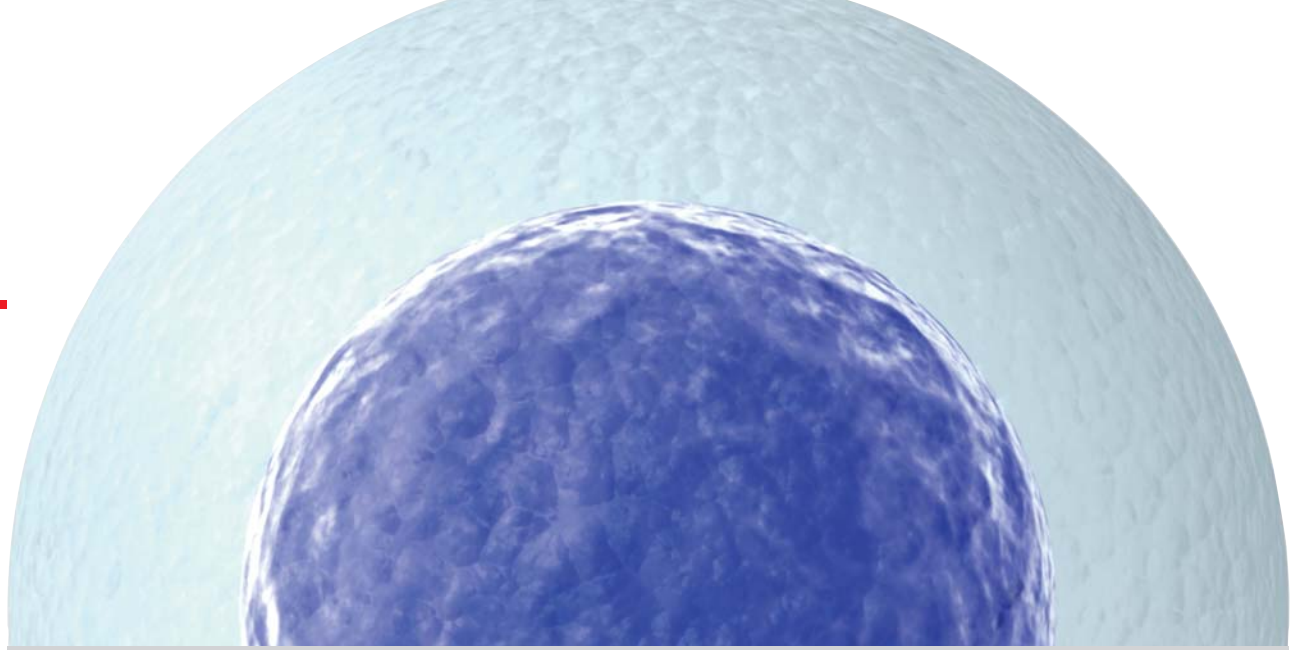

シングルセルソーティング

MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、6ウエル～1536ウエルプレートのソーティングにも標準で対応しています。さらに、スライドグラスやプレートのウエルタイプをカスタマイズすることも可能です。MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、希少な細胞集団を見つけ出し純度99%以上でソーティングすることができ、さらに液滴内の中心に細胞が1つのみいるドロップレットをソーティングする設定も可能なので、シングルセルソーティングに最適です。シングルセルソーティングは、細胞のクローニングだけではなく、シングルセルからの遺伝子発現解析など様々なアプリケーションに応用できます。

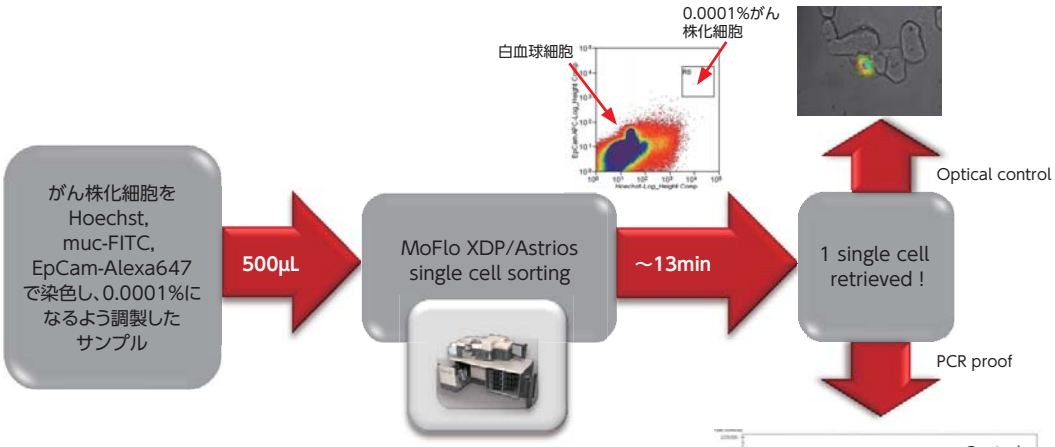

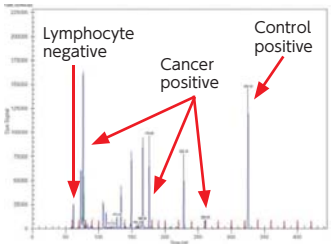

がん株細胞ソーティング解析例

0.0001%のがん株化細胞を検出し、シングルセルソーティング後、リアルタイムPCRを行いました。MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、単一細胞レベルで遺伝子発現解析を行うことができます。

1536ウエルソーティング

MoFlo Astrios *EQ/EQs*は標準で1536ウエルプレートに対応しています。シングルセルソーティングで網羅的な遺伝子発現解析などに対応します。

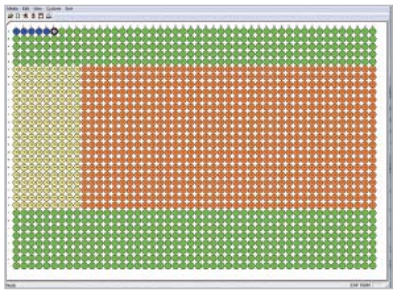

Cyclone設定画面
(プレートの各ウエルへのソート条件設定)

SortIndex

各ウエルにソーティングされた細胞がヒストグラム/ドットプロット上にマッピングできます。また、Kaluza ソフトウエアとの連携で、プレートにソーティングした各細胞1つ1つの蛍光強度や散乱光のデジタルデータを出力することができます。

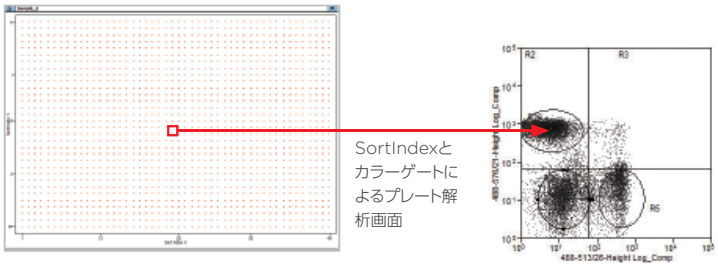

SortIndexとカラーゲートによるプレート解析画面

MoFlo Astrios *EQ/EQs*のソーティングテクノロジー

MoFlo Astrios *EQ/EQs*は、すべてのソートストリーム、ウエストストリームの角度を自由に変更できます。サイドストリームを直進（0℃）に設定することが可能なので、平面に置かれたマイクロタイタープレートへも垂直に細胞を落下させることができます。垂直落下方式は、従来の偏向したストリームによるマイクロタイタープレートへのソーティング時に起こるウエル壁への細胞の落下のリスクを最小化し、より確実な細胞の回収と細胞へのストレスを最小化します。さらに、正確・精密なアームの動きを実現するR-Theta CyCloneとの組み合わせにより、MoFlo Astrios *EQ/EQ*sは、1536プレートへのシングルセルソーティングできる性能を発揮します。

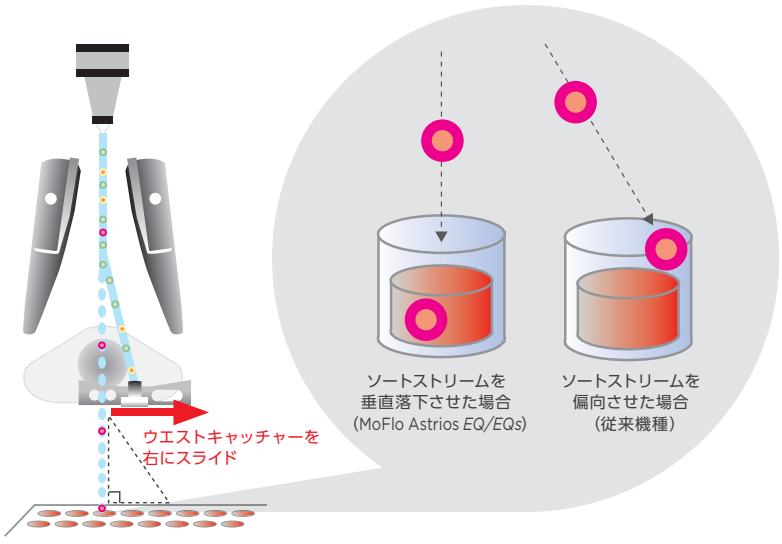

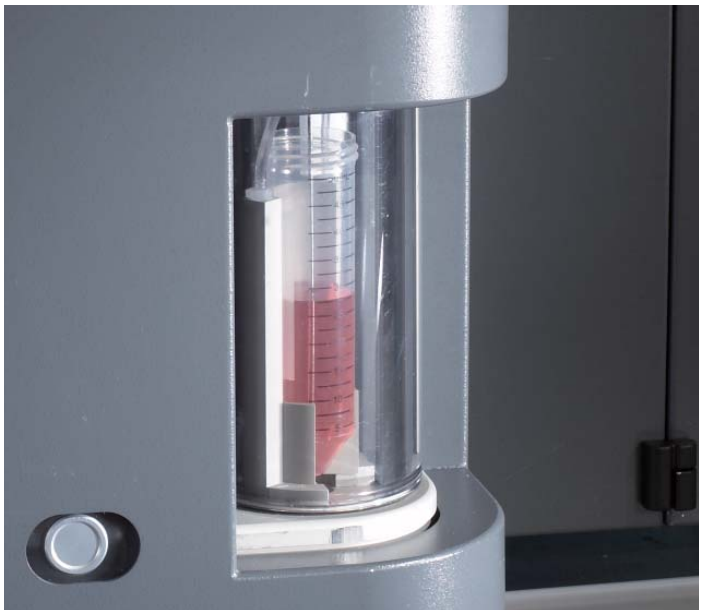

Easy to Use

より使いやすく

MoFlo Astrios *EQ/EQs*には、セルソーターを使いやすくする様々な機能を搭載しています。
Fiber Beam Conditioning Optics (FBCO) で6レーザーを1つにカップリングし、ファイバーで検出部の側まで導き照射することでレーザー間の軸のずれをなくしました。すべての操作は使いやすいタッチスクリーンで、機器のセットアップからメンテナンスまでを複雑な手順なしに行うことができます。

最新の光学系による簡単操作

6レーザーを異軸の状態で1つに束ねる最新光学系により、レーザー間ディレイの調整をなくし、シンプルなアライメント確認を実現しました。機器調整は、QCソフトウエアにより自動的に調整・確認されます。確認結果はログファイルに記録され、使用時の機器の状態をレビューすることができます。

使いやすいタッチスクリーンソフトウエア

専用に開発されたタッチスクリーンソフトウエアは、迷いのない直感操作を提供します。スタートアップのスケジュール機能、自動QC機能、自動ソートセットアップ/ 自動液滴安定化機能 (IntelliSortⅡ) など、セルソーターのセットアップをより簡単かつ短時間で行えるソフトウエアです。

スタートアップスケジュール
設定した時間にレーザーを自動的にスタートアップすることができます。MoFlo Astrios *EQ/EQs*をすぐにスタートアップできます。

自動QC
自動でレーザー間ディレイを設定し、各チャンネルのQCを自動確認します。QCの結果はログとして保管されます。

インテリソートⅡ
自動で最適な液滴状態を設定します。Astrios *EQ/EQs*の画像解析技術でビーズ不要のディレイタイムの自動計算と、自動で液滴安定化を行います。

容易なシャットダウン
シャットダウンウイザードと人間工学に基づいた構造で、メンテナンスをサポートします。

MoFlo Astrios *EQ/EQs*のバイオセーフティキャビネットは、日本工業規格（JIS K 3800：2009）に対応しています。バイオセーフティキャビネットとエアロゾル除去システムを併用することも可能です。
MoFlo Astrios *EQ/EQs*はメンテナンス性と安全性の高いデザインを採用しました。すべて前面アクセスで操作できるデザイン、取り外し可能なソートチャンバードアや角のないソートチャンバーなど、人間工学に基づいたデザインです。

Bio-Safety

バイオセーフティ＆人間工学に基づいたデザイン

MoFlo Astrios *EQ/EQs*のバイオセーフティは、安全性を高めるため3つのインターロックを付けました。生物学的な汚染の可能性が発生した場合、10秒以内にインターロックが作動し自動的に3つの安全策を行います。

- ソーティングをストップ
- サンプルの流れをストップ
- シース液の流れをストップ

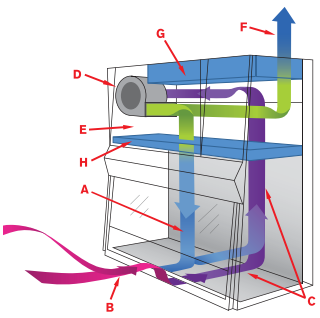

- バイオセーフティキャビネット（BSC）とMoFlo Astrios *EQ/EQs*のインテグレーションにより、NSF-49 規格に準拠します。
- エアロゾルの発生を抑える3つのインターロックセーフティシステムは、BSCと同時に使用できます。
- BSCは一般的な研究室に設置可能です。

部屋のエア　汚染エア（陽圧）
汚染エア（陰圧）　HEPA フィルター透過エア

SterilGARD Biosafety Cabinet のエアの流れ。 **A:**フィルター透過のダウンフローエア、**B:**部屋のエア、**C:**汚染エア、**D:**ブロアモーター、**E:**プレナム、**F:**フィルター透過後の排気、**G**、**H:**HEPA フィルター

BSC内のMoFlo Astrios *EQ/EQs* 周囲のエアフローパターンは、汚染されたエアストリームからサンプルとオペレータの両方を保護します。状態をモニタリングし、危険な状態になった場合は、MoFlo Astrios *EQ/EQs*をシャットダウンし、安全を維持します。

Service and Support

ベックマン・コールターのサポート体制

ベックマン・コールターはグローバルな理化学機器メーカーとして、製品の品質だけでなく、安心してご使用いただくためのサービスにも力を入れています。点検や修理はもちろん、試薬のアプリケーションや操作研修まで、お客様のご要望に応じたサービスを提供いたします。

修理および機械操作等のお問い合わせ

0120-826-777 または 03-6745-4705

電話受付時間：9：00～17：30（土・日・祝日・その他休業日を除く）

サービスプログラム

機器の安全を担保し、最良のコンディションでお使いいただくための各種サービスプログラムをご用意しています。高い技術をもった弊社フィールドエンジニアがご提供するサービスプログラムは、保守契約、クオリティメンテナンス、確認プログラムなどから、ご施設の使用状況やご予算に合わせておえらびいただけます。

セルソーター Two Day スクール

2日間でセルソーター MoFlo Astrios *EQ/EQs*、MoFlo XDPの操作方法を学習できるスクールです。東京ビジョンセンターにて、定期的に開催しています。
弊社サイトメトリー専門Webサイト「サイトメトリードットコム」で、開催日程をご案内しています。

サイトメトリードットコム

ベックマン・コールターの「サイトメトリードットコム」は、年間20万人が訪れるサイトメトリー専門Webサイトです。製品情報はもちろん、サイトメトリーの原理説明から多彩なアプリケーションの解説まで、最新情報を提供しています。

FCMを使用するすべての方のためのサイトメトリー専門Webサイト「サイトメトリードットコム」はこちらから

https://www.bc-cytometry.com/

ハイエンドハイスピードセルソーター　MoFlo Astrios *EQ/EQs*

主な仕様

性能	
前方散乱光検出感度	0.2 µm
蛍光検出感度	FITC　＜125MESF、PE　＜110MESF (Spherotech　8-Peakビーズ、488nmレーザー)
解析速度	100,000イベント／秒
サンプル分取速度	70,000イベント／秒
純度	＞ 99%（1%陽性集団をノズル径70 µm、シース圧60PSI、70,000イベント／秒でソーティング時）
ソーティング性能	
分取法式	液滴荷電方式
液的形成	最大200,000個／秒 (200 KHz)
液的安定化	CCDカメラにより液滴の感覚を一定に制御。流路の詰まり等の検出時はサンプルおよびソーティングを自動停止。 IntelliSortⅡ、Sort　Rescuer
分取条件設定	自動 (液的画像解析アルゴリズムによりビーズレスでの自動セットアップ) IntelliSortⅡ
分取方向	2 ～ 6方向
マイクロタイタープレート	標準装備 CyCloneⅡ (6、24、96、384、1,536ウエル、カスタムプレート)
スライドグラス	標準装備 CyCloneⅡ (インデックスソート、1,536スポットまでカスタマイズ可能)
サンプル／分取温度管理	標準装備 Coolingキット (※ 温度制御は低温恒温槽 (オプション) による)
エアロゾル除去	Aerosol Evaluationシステム (オプション)
バイオセーフティ	JIS K 3800 : 2009対応　バイオセーフティキャビネット (オプション)
光学系	
搭載レーザー * (波長／出力) *7本まで選択搭載可能	355 nm　空冷レーザー　／100 mW 488 nm　空冷レーザー *　／200 mW (150mw) 561 nm　空冷レーザー　／200 mW 642 nm　空冷レーザー　／100 mW 405 nm　空冷レーザー　／55 mW 532 nm　空冷レーザー　／150 mW 592 nm　空冷レーザー　／200 mW *EQ : 200 mW　EQs : 150 mW
ピンホール数	7
検出器	前方散乱光 : PMT × 2個*、側方散乱光 : PMT、蛍光 : PMT PMT最大51ポジション* *EQs : 前方散乱光　PMT 1個、最大50ポジション
流路系	
ノズル径	標準装備 : 70、100 µm 50、70、80、90、100、120、150、200 µm　8種類に対応
サンプルチューブ	0.5 mL、1.0 mL、1.5 mL、5 mL、7 mL、15 mL、50 mLチューブに対応
信号処理系	
波形処理分解能	100 MHz (0.01秒間隔、秒間1億回)、23ビット (8,388,608レベル)
信号解像度	32ビット (4294967296チャンネル)
蛍光ダイナミックレンジ	9ディケードログ (表示　4～9ディケード可変)
前方散乱光ダイナミックレンジ	0.2 ～ 30 µm
パルス処理	高さ、面積、幅、比率、時間
スレッショルド	すべてのパラメータで設定可能
同時取得パラメータ	最大32パラメータ
蛍光補正	20 × 20
寸法／重量	
本体	1,650 (W) × 770 (D) × 1,295 (H) mm、567 Kg (重量は搭載レーザーにより異なる)
エアコンプレッサ	450 (W) × 665 (D) × 861 (H) mm
サークステーション	191 (W) × 457 (D) × 429 (H) mm、10.5 Kg
電源	100 V、50／60 Hz

本内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

Beckman Coulter、Beckman Coulterロゴ、CyCloneおよびMoFloは、Beckman Coulter, Inc.の商標です。
他の会社名、製品名およびサービスは、それぞれの所有する商標です。

⚠注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の商標です。

⚠ **注意** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

ベックマン・コールター株式会社

本　　社：〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー

お客様専用 0120-566-730　☎ 03-6745-4704　FAX 03-5530-2460
e-mail bckkcas@beckman.com　URL http://www.beckmancoulter.co.jp

CE9915 2018.1-1000(L)